

## **Kolumna anestezyjologiczna**

### **Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych**


**Producent:**

**Model/ Typ:**

**Rok produkcji:**

<b>LP.</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	<b>WYMAGANA WARTOŚĆ</b>	<b>OFEROWANA WARTOŚĆ I OPIS</b>
1.	Urządzenie przeznaczone do instalacji na sali operacyjnej (Sala cięciowa oraz histeropatii)	<b>TAK</b>	
2.	Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.	<b>TAK</b>	
3.	Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.	<b>TAK</b>	
4.	Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą lub płytami połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.	<b>TAK</b>	
5.	Ramię kolumny dwuczęściowe, o łącznym zasięgu min. 1750 mm	<b>TAK (podać)</b>	
6.	Głowica o długości od strony frontowej min. 1200mm	<b>TAK (podać)</b>	
7.	Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska od 30 do 330o.	<b>TAK</b>	
8.	Konsola kolumny obrotowa w zakresie 330o z możliwością zatrzymania	<b>TAK</b>	
9.	Udźwig kolumny min 150 kg.	<b>TAK (podać)</b>	
10.	Kolumna wyposażona w hamulce elektropneumatyczne lub elektromagnetyczne przyciski umieszczone w dwóch uchwytach oznaczonych kolorami z przodu półki	<b>TAK</b>	
11.	Ramiona w kształcie trapezu lub prostokąta z zaokrąglonymi bokami	<b>TAK</b>	
12.	Głowica o przekroju w kształcie trójkąta, trapezu lub litery „U” z zaokrąglonymi bokami ramion, od strony frontowej z szynami montowanymi wzdłuż konsoli	<b>TAK</b>	
13.	Głowica z obciążeniem minimalnym 150 kg o długości min. 1200 mm	<b>TAK (podać)</b>	

14	Konsola pionowa obrotowa w zakresie od 30 do 330 stopni wyposażona w system hamulców mechanicznych w standardzie (opcja elektropneumatyczne lub elektromagnetyczne)	<b>TAK</b>	
15	Gniazda gazów medycznych umieszczone na bocznej ścianie w odseparowanym przedziale natomiast elektryka umieszczona po drugiej stronie w również odseparowanym przedziale.	<b>TAK</b>	
16	Punkty poboru gazów medycznych typu AGA: - 2 x AIR - 2 x VAC - 2 x O2 - 1 x AGSS - 1 x N2O	<b>TAK</b>	
17	Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne -8 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz -8 x gniazdo ekwipotencjalne	<b>TAK</b>	
18	Wykonana z profilu z aluminium, pokrytego warstwą lakieru.	<b>TAK</b>	
19	Główica z oświetleniem nocnego LED zamontowanego w jej dolnej lub tylnej części	<b>TAK</b>	
20	1 półka o wymiarach całkowitych min. 550 x450mm (szerokość x głębokość) wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie. Obciążenie minimalne 40 kg. Jedna półka w z zamontowanymi szynami 25 x 10 mm Druga półka wyposażona w uchwyty z pneumatycznymi lub elektropneumatycznymi hamulcami.	<b>TAK (podać)</b>	
21	1 x wyciągnik wieszaka kroplówki min. 30 cm wyposażone w drążek teleskopowy.	<b>TAK</b>	
22	Szuflada pojedyncza o wymiarach min. 512 x 370 x 139 mm zamontowana pod najniższą półką		
23	Urządzenie medyczne klasy IIb.	<b>TAK</b>	
24	Deklaracja zgodności CE.	<b>TAK</b>	
25	Powiadomienie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie	<b>TAK</b>	

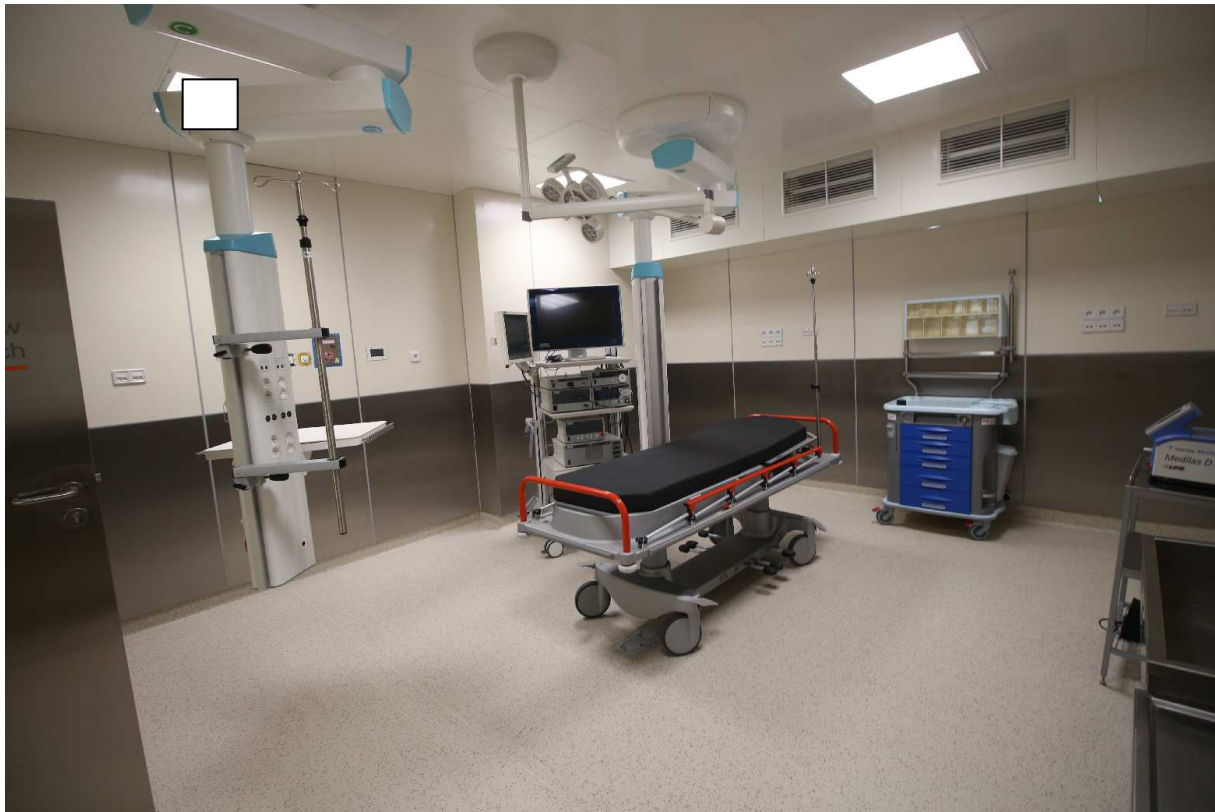

Rysunek poglądowy

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań nie gorszych niż wskazane powyżej.**

Zamawiający jako równoważny rozumie całokształt cech składających się na kształt, postać danego elementu przedmiotu zamówienia, a w szczególności: podane wymiary, podane kształty, podane parametry funkcjonalno – użytkowe.

Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że Wykonawcy nie są związani podanymi rysunkami w tym sensie, że oferowane urządzenie musi odpowiadać dokładnie wymiarom i proporcjom z rysunków, które zgodnie z treścią SIWZ mają charakter poglądowy.

Wiążącą bezwzględnie jest treść opisu danego elementu sam zaś rysunek jest wskazaniem wzorca, do którego winien dążyć kształt (forma) urządzenia. Stanowi zatem także wzornik, w stosunku do którego oceniana będzie równoważność w zakresie kryterium formy i kształtu.